

「より理解を深める！体液電解質異常と輸液」〈4版1刷〉正誤表
(2026年7月現在)

「より理解を深める！体液電解質異常と輸液」〈4版1刷〉をご購入いただきまして誠にありがとうございます。本書に以下の誤りがございましたので、ここに訂正・加筆させていただきますとともに深くお詫び申し上げます。

149頁 4行目

[2026/7/21]

(誤) 1未満なら500mL以下, 1前後なら500~700mL, 1以上なら1000mL以下とする方法
(正) 1未満なら1000mL以下, 1前後なら500~700mL, 1以上なら500mL以下とする方法

149頁 9行目


[2026/7/21]

(誤) $<1 \Rightarrow <500\text{mL}$, 1前後 $\Rightarrow 500\sim 700\text{mL}$, $>1 \Rightarrow <1000\text{mL}$
(正) $<1 \Rightarrow <1000\text{mL}$, 1前後 $\Rightarrow 500\sim 700\text{mL}$, $>1 \Rightarrow <500\text{mL}$


252頁 図4-9

[2026/4/22]

(誤)

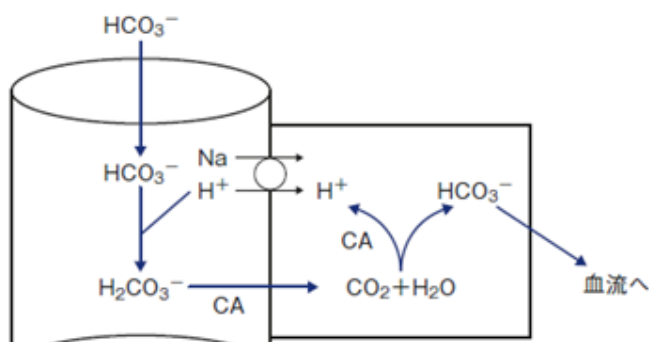

(正)

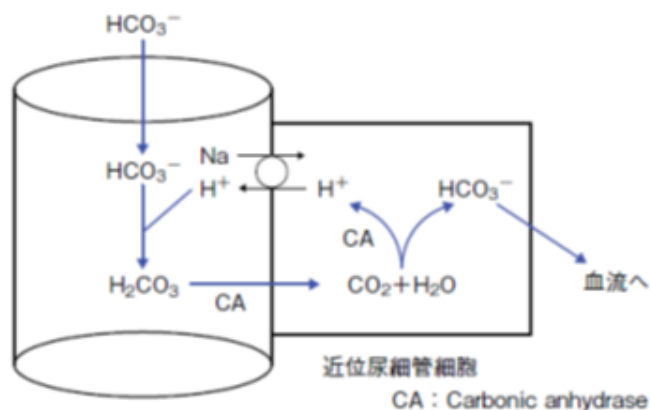

245頁 7行目

[2026/4/22]

(誤) 細胞外では蛋白ヒスタチン残基

(正) 細胞内では蛋白ヒスタチン残基